Sthetique

B E D I E N U N G S A N L E I T U N G

AQUASPRAY PODODENT 2L

50870

Dieses Gerät wurde gemäß den CE-Vorschriften der Europäischen Union entworfen und gebaut. Ein CE-Typenschild mit den vorgeschriebenen technischen und elektrischen Daten finden Sie auf all unseren Geräte.

Obwohl alles mögliche getan wurde um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, ist völlig und sorgfältiges Lesen dieser Bedienungsanleitung vor der Ingebrauchnahme bestimmt notwendig. Ziehen Sie sich in Zweifelsfällen zu Rate bei Ihrem Lieferanten.

50870-manual_de.002 Okt-02; print Feb-03

AQUA SPRAY PODO

INHALTSVERZEICHNIS

1 ALLGEMEINE INFORMATION 3

1.1 Vorwort 3

1.2 Besondere Merkmale des *S-Thetique* Aquaspray Pododent 3

1.3 Zur sicheren Benutzung 4

1.4 Teile und Tastenordnung 5

2 VORBEREITUNGEN AUF DEM GEBRAUCH 6

2.1 Befüllen des Behälters 6

2.2 Fräser ersetzen 6

2.3 Speichern der bevorzugten Spray- und Motor-Einstellungen 7

2.4 Zeiteinstellung 7

3 BEDIENUNG DES *S-THETIQUE* AQUASPRAY PODODENT 7

3.1 Bedienungs- und Behandlungshinweise 7

3.2 Unterbrechen und beenden der Behandlung 8

4 PFLEGE UND TECHNISCHE DATEN 9

4.1 Pflege 9

4.2 Wartung 10

4.3 Technische Daten 10

1 ALLGEMEINE INFORMATION

1.1 Vorwort

Wir gratulieren Ihnen zur Erwerbung Ihrer *S-Thetique* Aquaspray Pododent. Wir sichern Ihnen, dass Sie eine ausgezeichnete Wahl getroffen haben. Einmal mehr bestätigt der Hersteller Dancohr Corporation seinen Ruf als führende Entwickler fortgeschrittener Technologien. Alle Neuentwickelungen machen den Aquaspray Pododent zum anspruchsvollsten Fußpflegegerät auf dem Markt. Spezielles Augenmerk wurde auf Verlässlichkeit, Sicherheit, Langlebigkeit und Leichte Bedienung gerichtet. Zudem trägt der künstlerische Entwurf zur professionellen Ausstrahlung Ihres Instituts bei. Sorgfältiges Lesen dieser Bedienungsanleitung ist von Bedeutung um die viele Möglichkeiten vollständig zu benutzen und weil für einen sicheren Betrieb einige Vorsorgsmaßnahmen zu beachten sind. Bewahren Sie sie an einer zugänglichen Stelle auf um sie wenn nötig an der Hand zu haben.

1.2 Besondere Merkmale des *S-Thetique* Aquaspray Pododent

Beim körperbetont entworfen Pododent 2L Handstück hat einen Drehzahl van 40.000 UPM und dessen Vorderteil kann zur Desinfektion in der Autoclav abgekoppelt werden. Als besonderes Merkmal hat es einen eingebauten Lichtleiter. Dieser beleuchtet genau die Stelle an der gerade gefräst wird. Drücken Sie die 2 Teile immer richtig zusammen und drehen Sie bis es klickt, damit das Licht richtig in den Kopf geleitet wird. Als Sonderzubehör ist für das Handstück einen Contra-angle-Aufsatz erhältlich (auch mit integrierter Lichtquelle) womit eine im maßstab 5:1 reduzierten Geschwindigkeit zur Zunahme der Drehzahl auf 200.000 UPM führt (Referenznummer Oktober 2002 noch unbekannt Abbildung C). Die Fräseraufnahme is wird durch einem Metallstäbchen geschützt. Bewahren Sie es, falls Sie das Gerät transportieren oder es geprüft oder repariert werden muss.

Abbildung B: Der Pododent Pododent 2L, mit der Lampe im Kopf gehört zum Lieferumfang des 65070

Abbildung C: Der optionelle Contra-angle-Aufsatz

Das Handstück ist mit oder ohne Spray zu verwenden. Die Sprayfunktion wirkt aber nur beim eingeschalteten Motor. Ein klar leserliches Displayfeld gibt ständig alle notwendige Auskunft über die aktuelle Einstellungen. Der innenbeleuchtete, extra große stoßfeste Spraybehälter ist zum Nachfüllen und Reinigen einfach herauszunehmen. Die Bedienung findet statt über ein flaches, wasserdichtes Tastenfeld mit soft-touch Tasten, was auch zur leichten Pflege beiträgt. Für die Bedienung der 4 wichtigsten Funktionen ist als Sonderzubehör eine mit dem Fuß steuerbaren drahtlose Fernbedienung erhältlich (Abbildung O, Referenznummer **66065**). Drei Motor- und drie Sprayeinstellungen sind innerhalb wenigen Sekunden zu speichern. Zur Vorbeugung von stürzen des Handstücks befindet sich eine Handliche Ablage an der Oberseite Ihres Aquaspray Pododent. Diese Ablage dient auch als handlicher Tragegriff. Verbinden Sie das Gerät mit dem mitgelieferten Netzkabel mit einer geerdeten Wandsteckdose oder -Leiste.

> ☛ ***TIPP***
> Halten Sie einen zusätzlichen Behälter in Bereitschaft wenn Sie mehrere Sprayflüssigkeiten verwenden. Das ermöglicht Ihnen schneller zwischen den Behandlungen zu wechseln.

1.3 Zur sicheren Benutzung

Jedes Mal wenn Sie das Gerät zu Gebrauch stellen sollten Sie folgende Sicherheitshinweise und Vorkehrungen beachten:

- Halten Sie das Gerät außer Bereich von Kindern und Unzuständigen
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- Eine einwandfreie Luftzirkulation ist erforderlich, um den Spray abzuführen und um zu verhindern, dass sich im Gerät ein Wärmestau entwickelt. Blockieren Sie niemals die Belüftungsöffnungen an allen Seiten des Geräts.
- Ethanolenthaltende Sprayflüssigkeiten sind leicht entzündlich. Rauchen, auch von Ihren Kunden, ist also unerwünscht. Die Kombination von Spraygasen und Cigarettenrauch ist außerdem giftig. Auch unabgedeckte Lebensmittel halten Sie bei Sprayverwendung lieber aus der Nähe.
- Stellen Sie den Aquaspray Pododent nicht in der Nähe einer Heizquelle, wie zum Beispiel Heizkörpern oder Heißluftgittern, auf. Er darf auch nicht direkter Sonnenstrahlung ausgesetzt werden.
- Ihr Aquaspray soll nicht unmittelbar nach extremen Temperaturschwankungen (z.B. nach einer kalten Nacht im Auto) eingesetzt werden. Das Gerät vorzugsweise bei Zimmertemperatur verwenden.
- Der Aquaspray Pododent ist nicht geeignet für Gebrauch (und Lagerung) in feuchten Räumen wie Badezimmer. Lesen Sie die Umgebungsanforderungen im letzten Paragraph dieser Bedienungsanleitung: *Technische Daten und Garantie*. Erwägen Sie, dass auch die Benutzung von Dampfgeräten im gleichen Raum die Luftfeuchtigkeit beeinflusst. Stellen Sie dazu einen Feuchtigkeitsmesser im Raum auf.
- Betätigen Sie niemals die Motor-Taste wenn kein Fräser in der Fräseraufnahme steckt und achten Sie darauf, dass Sie diesen gut verriegelt haben. (Abbildung D).

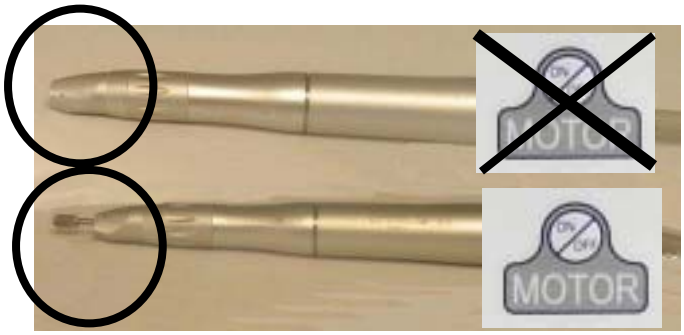

Abbildung D: Schalten Sie Ihr Aquaspray nie ein wenn kein Fräser eingesetzt ist

- Verbinden Sie die Netzstrombuchse des Geräts mit dem beigelieferten Leitungsschnur an eine geerdete Steckdose oder Stromleiste. Überzeugen Sie sich das erste Mal, dass die örtliche Spannung mit den Angaben auf dem CE-Typenschild übereinstimmt und die Steckdose geerdet ist. Stecken Sie den Stecker immer mit trockenen Händen.
- Falls das Gerät beim Einschalten nicht reagiert, prüfen Sie ob das Netzkabel richtig steckt und der Netzschalter an der Rückseite eingeschaltet ist. Falls das alles in Ordnung ist, versuchen Sie zuerst ein anderes Gerät. Wenn dieses Gerät es tut ist möglicherweise der Sicherungseinsatz durchgebrannt. Dieser befindet sich an der Rückseite des Gerätes und steckt im Fach oberhalb der Netzkabelbuchse. Dieses Fach ist mit einem Schraubenzieher zu lösen. Wenn der Sicherungseinsatz nach Auswechslung wieder durchbrennt oder das Gerät schaltet sich noch immer nicht ein, ziehen Sie den Netzstecker und nehmen Sie Verbindung auf mit dem Vertreiber. Öffnen Sie das Gerät unter keinem Beding selbst!

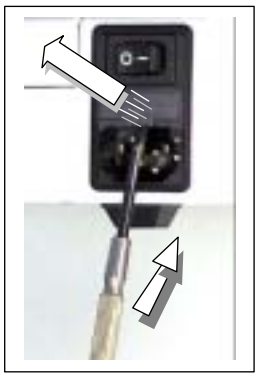

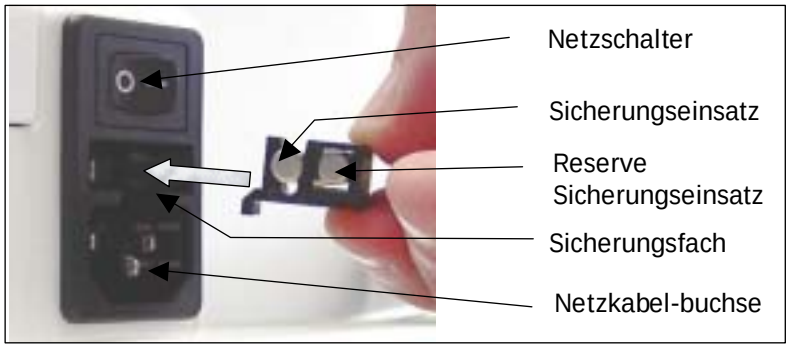

Abbildung E: Auswechslung des Sicherungseinsatzes. Heben Sie mit einem Schraubenzieher das Schublädchen aus dem Fach (linkes Bild), ersetzen Sie Ihn und drücken Sie ihn zurück bis er einrastet (rechtes Bild)

- Falls eine Flüssigkeit ins Innere des Gerätes gelangt oder das Handstück fällt zu Boden, schalten Sie das Gerät dann unverzüglich aus. Holen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät von Ihrem Lieferanten überprüfen.
- Verwenden Sie den optionellen hartschalen Podocase Luxuskoffer zur sicheren Lagerung und Transport. Er verfügt über mehrere weichgepolsterten Innenfachen für Zubehör. Zwei Rollen und einem ausziehbaren Ziehgriff vereinfachen den Transport. (Abbildung F, erhältlich unter Referenznummer **66060**). Ebenfalls erhältlich ist der speziell entworfen Podopouch Beutel unter Referenz **66062**.
- Schützen Sie sich während der Behandlung eines Kundes vor möglicher Ansteckung und Haut- Augen- und Kehlenreizungen immer mit:
  * Handschuhen
  * Schutzbrille
  * Einer plastifizierten Mund- und Nasenmaske
  * Schutzkleidung (Baumwolle)

Abbildung F: Der Podopouch (linksoben) und der Podocase Luxuskoffer auf 2 Rollen und mit ausziehbahrem Ziehgriff

1.4 Teile und Tastenordnung

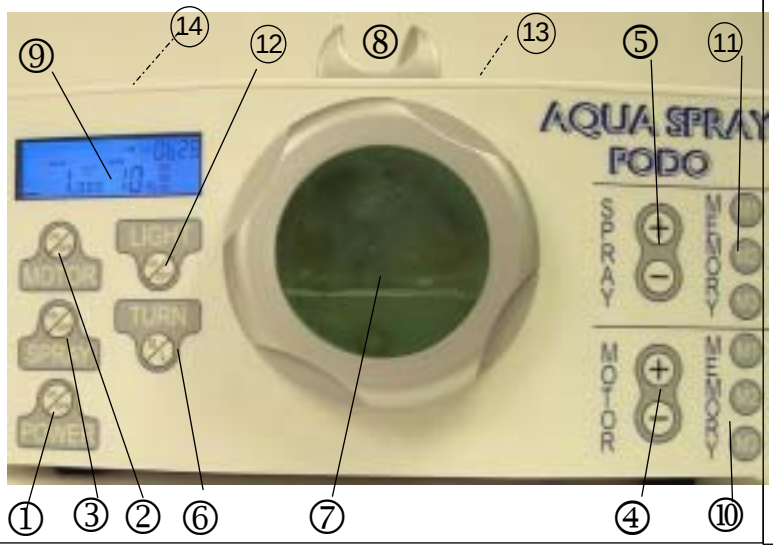

① Ein-Aus Taste (Power)
② Motor Taste
③ Spray Taste
④ Drehzahltasten
⑤ Spraymengetasten
⑥ Laufrichtungstaste
⑦ Spraybehälter
⑧ Handstückablage und Griff
⑨ Displayfeld
⑩ Motoreinstellungen-Speicher
⑪ Sprayeinstellungen-Speicher
⑫ Lichttaste für Handstück
⑬ Handstückfach (Rückseite)
⑭ Netzschalter, Sicherungsfach und Netzkabelbuchse (Rückseite)

Abbildung G: Bezeichnung der Teile und Tasten

2 VORBEREITUNGEN AUF DEM GEBRAUCH

2.1 Befüllen des Behälters

Zum (Nach)füllen des Spraybehälters, ziehen Sie Ihn gerade in Ihre Richtung und befüllen Sie Ihn. Der Behälter hat eine Nutzinhalt von nicht weniger als 400 cl. Beim Pododent 2L Handstück können Sie normales Leitungswasser verwenden. Das spart eine erhebliche Summe an Sprayflüssigkeiten. Zur täglichen Desinfektion, sollen Sie allerdings eine Flüssigkeit mit einem Ethanol-Anteil von mindestens 70 Prozent verwenden. Lesen Sie die Produktinformation auf der Verpackung und/oder auf der Packungsbeilage der Sprayflüssigkeit und folgen Sie den Anweisungen. Fügen Sie der Sprayflüssigkeit keine Essenzölen zu, diese können die Spraydüsen im Handstück verstopfen. Haushältliche Reinigungsmittel greifen das Motoren-Innere an. Der Vertreiber oder der Hersteller Dancohr Technics haften nicht für die Verwendung falscher Sprayflüssigkeiten. Stellen Sie nach der Befüllung den Behälter wieder zurück. Schieben Sie dabei die 2 Vorsprünge an der Unterseite des Behälters in die 2 Löcher innerhalb des Gehäuses. Das ist der Fall, wenn die 2 Vorsprünge eine senkrechte Gerade bilden. (Abbildung I)

Abbildung H: Der Behälter

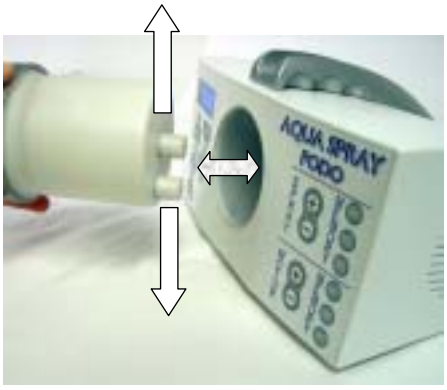

Abbildung I: Die 2 Vorsprünge des Behälters greifen in die Löcher die sich hinten im Fach befinden

> ☛ ***TIPP***
> Halten Sie während der Behandlung den Füllpegel im Auge. Wenn der Flüssigkeitsbehälter trocken fällt, aber auch wenn er längere Zeit nicht benutzt wird, kann es nach dem Beigeben etwa eine Minuten dauern bevor das Spraysystem sich wieder in Gang setzt. Das ist störend für Sie und ihre Kunden.

2.2 Fräser ersetzen

Das Pododent 2L Handstück verfügt über eine Automatikspannung womit Sie den Fräser innerhalb einigen Sekunden einsetzen oder auswechseln können. Drehen Sie den Verriegelungsring leicht bis Sie keine Wiederstand mehr spüren. Stecken Sie dann einen neuen Fräser ein und drehen Sie den Ring 2 Huben zurück wobei es zweimal klickt. Stecken Sie den Fräser so tief wie möglich ein. Der optionelle Contra-angle-Aufsatz ist mit einem *Ultra Push* Druckknopf gerüstet (Abbilding M).

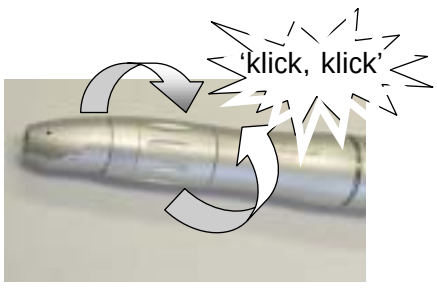

Abbildung I: Drehen Sie den Verriegelungsring 2 Huben um den Fräser einzusetzen oder herauszunehmen

Abbildung M: Beim *Contra-angle*-Aufsatz brauchen Sie zum Fräserwechsel nur den Knopf eingedrückt zu halten.

2.3 Speichern der bevorzugten Spray- und Motor-Einstellungen

Als besonderes Merkmal verfügt der *S-Thetique* Aquaspray Pododent über 6 einfach zu programmieren Speicherpositionen: 3 für Drehzahl und 3 für den Spray. Zum Festlegen dieser Einstellungen stellen Sie zuerst den Drehzahl oder Spraystarke in die bevorzugte Zahl. Anschließend drücken Sie 2 mal kurz hinter einander die **Memory** Taste unter welche Sie diese einstellung abspeichern möchten. Das nächste mal wenn Sie diese Einstellung benutzen wollen, brauchen Sie nur die entsprechende Taste zu betätigen und das Gerät schaltet sofort auf die gespeicherte Einstellung. Die gespeicherten Einstellungen bleiben in Kraft bis sie ersetzt werden. Die Elektronik Ihren Aquaspray hält die gespeicherten Einstellungen auch fest wenn das Gerät vom Stromnetz abgekoppelt worden ist.

2.4 Zeiteinstellung

Wenn Sie das Gerät zum ersten mal verwenden, muss die richtige Zeit noch eingestellt werden. Hierzu gehen Sie folgenderweise vor:

- Schalten Sie das Gerät ein über die ***Power*** Taste. Das Displayfeld leuchtet blau. Rechtsoben steht die Zeit.
- Halten Sie die ***Motor*** **M3** Taste eingedrückt (abb. Q-A) und anschließend sofort die ***Motor*** ⊖ Taste (Abb. Q-B);
- Halten Sie diese 2 Tasten gleichzeitig einige Sekunden eingedrückt, bis der Doppelpunkt in der Zeitangabe verschwindet;
- Über die ***Motor*** ⊕ und ⊖ Tasten (Abb. Q-B und Q-C) stellen Sie die Stunden ein und über die **Spray** ⊕ und ⊖ Tasten (Abb. Q-D und Q-E) die Minuten;
- Zum Schluss drücken Sie wieder die ***Motor*** **M3** Taste um die Zeiteinstellung abzuschließen. Der Doppelpunkt im Displayfeld erscheint wieder.

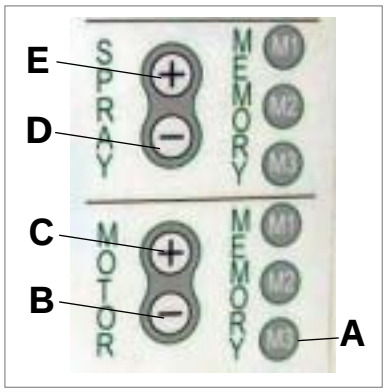

Abbildung N: Die Tasten zur Richtigstellung der Uhr

3 BEDIENUNG DES *S-THETIQUE* AQUASPRAY PODODENT

3.1 Bedienungs- und Behandlungshinweise

Erst wenn Sie alle obenstehenden Vorbereitungen durchgeführt haben und alle in Paragraph 1.3 erwähnten Sicherheitsvorkehrungen und Vorsorgsmaßnahmen beachtet worden sind, kann das Gerät eingeschaltet werden.

Abbildung O: Die optionelle Fernbedienung 500. Von linksoben in Uhrzeigersinne: Ein-Aus Taste (Power), links/rechtslauf, Motor ein/ab, Spray ein/ab

Abbildung P: Die Tasten zur Reglung des Spraynebels

Abbildung Q: Die Drehzahl-Regeltasten

- Nehmen Sie das Handstück aus dem Fach und halten Sie es in der Hand oder legen Sie es Sicher in die Ablage oben auf das Gerät.
- Drücken Sie (falls ausgeschaltet) den Netzschalter an der Rückseite. Die Zeitangabe erscheint im Displayfeld, weiter tut sich noch nichts. (Das Richtigstellen der Zeit entnehmen Sie bitte Kapittel 2.4)
- Drücken Sie anschließend die ***Power*** Taste auf dem Bedienfeld um das Gerät einzuschalten. Der Behälter wird jetzt innenbeleuchtet und das blau beleuchtete Displayfeld zeigt die aktuellen Einstellungen. Es summt kurzweilig. Stellen Sie die Einstellungen nach wunsch ein oder rufen Sie mit den einschlägigen Tasten die gespeicherten Motor- und Sprayeinstellungen hervor.
- Beim Pododent 2L Handstück können Sie mit der ***Light*** Taste die Lampe im Handstückkopf entzünden.
- Halten Sie das Handstück fest in der Hand und betätigen Sie die ***Motor*** Taste. Der Motor startet in der vom Displayfeld angezeigten Drehzahl. Die Düse neben der Fräseraufnahme bläst eine ständige erfrischende Luftzug.
- Drücken Sie, falls ausgeschaltet und wünschlich, anschließend die ***Spray*** Taste.
- Der Spray ist in 6 Stufen einzustellen: 50, 60, 70, 80, 90 und 100 Prozent. Für Zunahme der Spray drücken Sie wiederholt die ***Spray +*** Taste; Mit der ***Spray*** – Taste nimmt die Zufuhr ab. (Abbildung P)
- Über die ***Motor +*** und ***Motor*** – Tasten ist der Drehzahl in 8 Schritten von 5,000 auf 40,000 Umdrehungen Pro Minute (UPM) aufzustufen. (Abbildung Q). Die niedrichste Stufe eignet sich besonders zur Pflege der Fingernägel.
- Über die ***Turn*** Taste drehen Sie die Laufrichtung um. Diese wird mit einem Pfeil im Displayfeld gezeigt. Es ist nicht erforderlich, vor dem Umschalten den Motor abzustellen oder das der Motor stillsteht..
- Mittlerweile gibt das Displayfeld Auskunft über alle Motor- und Sprayeinstellungen, Laufrichtung, und Drehmoment, (*torque)* also die Bewegung die die Umdrehungen hervorruft. Der Software sorgt automatisch dafür, dass der Motor in der richtigen Gang läuft.

ZUR BEACHTUNG:
Stellen Sie bei der Fräserwechsel immer zuerst den Motor ab und warten Sie bis der Motor stillsteht.

- Üben Sie während der Behandlung nie Druck aus mit dem Fräser.
- Machen Sie rollende und keine ziehende Bewegungen mit dem Fräser. (Siehe Abbildung R).

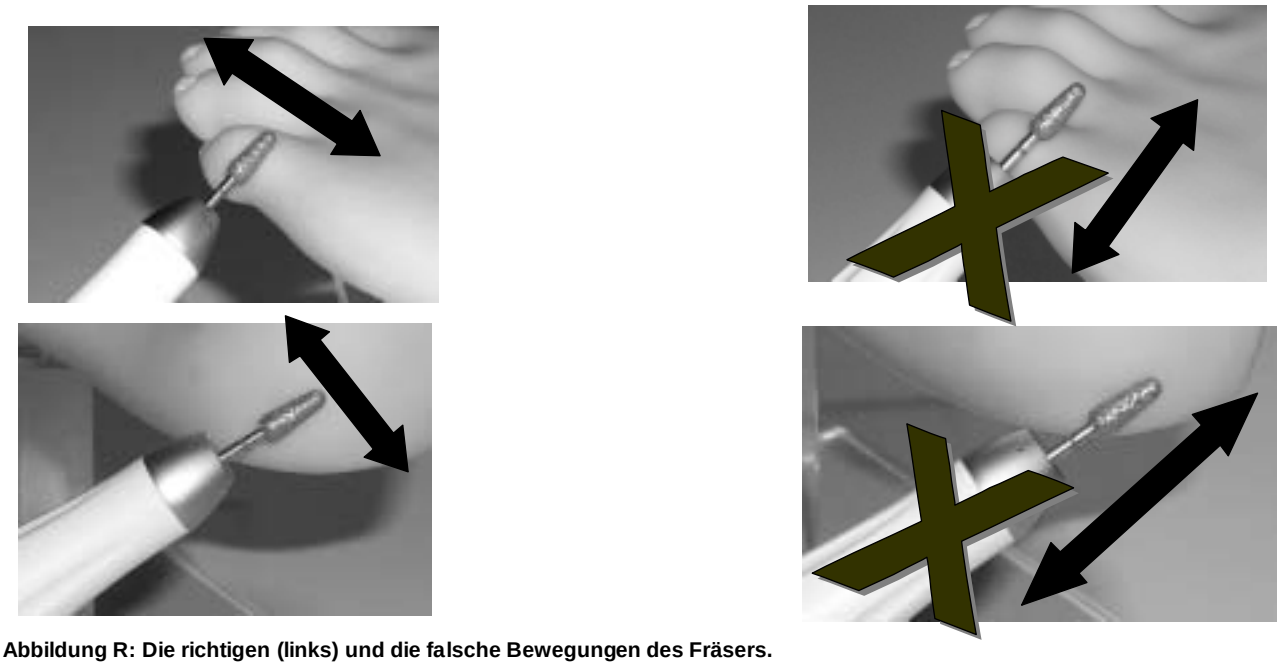

Abbildung R: Die richtigen (links) und die falsche Bewegungen des Fräsers.

3.2 Unterbrechen und beenden der Behandlung

- Legen Sie das Handstück beim Unterbrechen oder Beenden der Behandlung immer in die Ablage oben auf das Gerät. Damit kommen Sie Beschädigungen an Handstück oder Fräser wegen Stürzen zuvor.

- Wenn Sie nur den Spray unterbrechen oder beenden wollen, drücken Sie die ***Spray*** Taste. Der Motor setzt den Betrieb fort.
- Unterbrechen Sie die Behandlung durch Betätigung der ***Motor*** Taste. Sowohl der Motor als der Spray werden eingestellt. Das Gerät bleibt dennoch Betriebsbereit und das Displayfeld zeigt noch alle Einstellungen. Diese können beliebig geändert werden.

ZUR BEACHTUNG:
Zur Unterbrechung der Behandlung und auch beim Abschalten ist es nicht nötig um zuerst die Drehzahl beziehungsweise die Sprayzufuhr zurück zu setzen.

- Zum Beenden der Behandlung betätigen Sie die ***Power*** Taste. Es dauert einige Sekunden, bis die Anzeigen im Displayfeld erlöschen. Sie brauchen den Motor oder den Spray nicht vorher abzustellen.
- Wenn Sie wünschen, können Sie jetzt das Gerät abschalten mit dem Netzschalter an der Rückseite. Das ist nicht unbedingt notwendig, aber ratsam weil das die Stromkosten der Bereitschaft spart.
- Führen Sie die übliche Pflegearbeiten durch. (Dazu nächstes Kapittel).
- Das Handstück kann sicher im Fach an der Rückseite aufbewahrt werden. (Abbildung S) Beachten Sie dabei, dass der Fräser nicht ins Gedrängniss gerät. Das Fach macht den Aquaspray sehr geeignet für Hausbesuche.

Abbildung S: Fach zum Aufbewahren des Handstücks

ZUR BEACHTUNG!
Das Gerät hält alle Einstellungen fest, sogar wenn Sie den Netzschalter abschalten oder den Netzstecker ziehen.

4 PFLEGE UND TECHNISCHE DATEN

4.1 Pflege

- Ziehen Sie zuerst den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Tauchen Sie das Gerät und das Handstück nie unter Wasser oder Chemikalien.
- Verwenden Sie zum einfachen Reinigen des Gehäuses und Handstücks einen milden Allzweckreiniger. Sorgen Sie dafür, dass keine Flüssigkeiten ins Gehäuse eindringen kann, z.B. über die Belüftungslöcher an den Seiten.
- Desinfizieren Sie das Handstück oder Gehäuse nur mit einem mit einem 70-Prozentiger Ethanol-Lösung angefeuchteten Papiertuch, Wattebausch oder weichen Baumwolllappen.
- Wenn Sie als Sprayflüssigkeit eine desinfizierende Ethanollösung verwenden, dann brauchen Sie den Behälter und den Schlauch nach der Behandlung nicht zu desinfizieren. Füllen Sie sonst den Behälter mit einer (mindestens) 70-Prozentiger Ethanol-Lösung, schalten Sie den Motor und den Spray ein und lassen Sie das Gerät einige Minuten laufen.
- Reinigen Sie die Spraydüsen im Handstück mit einer weichen Zahnbürste (Abbildung T).

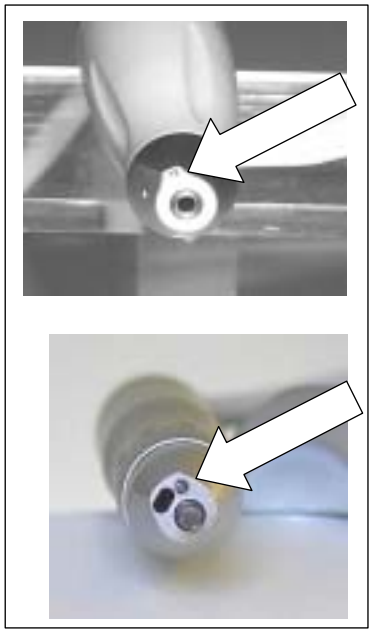

Abbildung T: Reinigen Sie auch die winzigen Spraydüsen

- Benutzen Sie einen Heißluftsterilisator oder Ultraschall-reiniger zum ausreichend desinfizieren von Fräsern und anderen Werkzeugen.
- Das Pododent 2L Handstücke erfordert mindestens zweimal wochentliche Ölung, was zu dessen Langlebigkeit beiträgt. Reinigen und Ölen Sie immer den Schaft des Handstücks bevor Sie Ihn Sterilisieren. Blutreste, Salzlösungen usw können das Metal angreifen. Der Gebrauch von PanaSpray wird empfohlen, da dieses Schmiermittel extra für Präzisionsapparaten wie Ihr Micromotor Handstück entwickelt wurde. Die Spritzdüse vom PanaSpray ist für den Pododent 2L geeignet.
- Zum Ölen des Handstücks gehen Sie folgenderweise vor: Stecken Sie die Spritzdüse der Sprühdose ganz in den Schaft des Handstücks. Halten Sie die Sprühdose aufrecht und drücken Sie die Spritzdüse fest in den Schaft zur Vorbeugung von Verunreinigung durch seitlich austretendem Öl. (Abbildung U oben). Drücken Sie den Sprühknopf 2-3 Sekunden, um sicherzugehen, dass das Öl optimal verteilt wird. Es empfiehlt sich, das Ölen am Abend durchzuführen, damit das Handstück über Nacht austropfen kann. Benutzen Sie dazu einen Becher.

Abbildung U: Das Ölen des Pododent 2L Handstück

4.2 Wartung

Es empfiehlt sich Ihr *S-Thetique* Aquaspray Pododent jährlich prüfen zu lassen. Sie können die Wartungsdienst von Ihrem Verteiler ausführen lassen oder sich wenden an eine von ihm autorisierte Werkstatt.

4.3 Technische Daten

	Standard (230 Volt)	**Option (115 Volt)**
Abmessungen (B x T x H)	270 x 265 x 145 mm	
Gewicht (ohne Handstück)	± 3.6 kg	
Gewicht Handstück Pododent 2	180 gr	
Nennspannung	AC 220-240 V; 50/60 Hz	AC 110-130 V 50/60 Hz
Maximale Leistungsaufnahme	125 Watt	
Leistungsaufnahme in **Power *off*** Position (betriebsberieschaft)	< 5 Watt	
Sicherungseinsatz	6.3 AT 250V	
Handstück Typ	NSK Pododent 2L	
Drehzahl	5.000-40.000 UPM in 8 Stufen	
Sprayabgabe	Auf 6 Stufen einstellbar: 50, 60, 70, 80, 90 und 100 Prozent	
Länge Handstückkabel	1,75 Meter	
Sicherheitssklasse	2	
Klassifizierung	BF	
IP Klassifizierung	IP20	
Geräuschentwicklung	.....dB	
Zulässige Betriebstemperatur	5 – 40 °C	
Relative Luftfeuchtigkeit	20 – 65 %	
Zulässige Lagerungstemperatur	-10 – 50 °C	
Aufstellposition	Waagerecht	
Lieferumfang	S-Thetique Aquaspray Pododent Gerät mit Pododent 2L Hand-stück; schwarzes Netzkabel; Ausnehmbarer Spraybehälter; Bedienungsanleitung	

Die Entwurfsabteilung des Herstellers Dancohr ist ständig auf die Suche nach neuen Technologien und Erkentnissen. Kleine Abweichungen von den in dieser Bedienungsanleitung benutzten Texten und in der Gestaltung sind deswegen möglich.

Das CE-Typenschild an der rechten Seite des Geräts enthält die folgenden (technischen) Daten:

- Spannungsversorgung: Voltzahl (V)
- Leistungsaufnahme: Watt (W)
- Frequenz (Hertz - Hz)
- Stromstärke der Printsicherung (Ampere AT)
- Modell des Geräts
- Herstellungsdatum

Dieses Typenschild ist eine Garantie dafür, dass das Gerät entsprechend den jüngsten Richtlinien der EU entwickelt und gebaut wurde. Entfernen Sie es nicht. Die Angaben sind von Bedeutung für die Garantieleistung und Sie brauchen sie falls Sie sich bei Ihrem Lieferanten zu Rate ziehen.

© Dancohr Corporation
Netherlands